

DÉSINFECTANT
DE HAUT NIVEAU

ANIOXYDE 1000 LD et BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

- Durée de conservation avant ouverture : 24 mois
- Formule brevetée
- Désinfectant de haut niveau issu du système PHERA®, actif sur les spores de bactéries
- Production extemporanée d'acide peracétique
- Alternative au glutaraldéhyde
- Sans aldéhyde : pas de fixation de protéine
- Contrôle de l'efficacité du bain avec des bandelettes



ECOLAB®

www.ecolab.com


ANIOXYDE 1000 LD

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux


CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur du bain : rose après activation
- Utilisation simplifiée : activateur intégré au bidon de 5 L
- Efficacité prouvée à 1000 ppm d'acide peracétique pour un spectre complet*
- Durée d'utilisation du bain de trempage : 14 jours maximum (7 jours pour la France). Vérifier la conformité du bain avec les bandelettes de contrôle
- Large compatibilité vis-à-vis des matérieaux, bacs et paillasses
- La solution désinfectante contient de 2000 ppm d'acide peracétique (après activation) à 1000 ppm (concentration limite du seuil detectée par bandelette de contrôle)


MODE D'EMPLOI




Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un détergent ou un produit pré-désinfectant. Pour le matériel d'endoscopie : brosser les canaux.



Etape de désinfection : Verser la solution activée (voir la procédure d'activation sur l'étiquette/le protocole). Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel d'endoscopie : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. N'ajouter aucun produit dans ANIOXYDE 1000 LD.



Rincer abondamment à l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.



Sécher avec un champ à usage unique. Garder le dispositif médical le plus aseptiquement possible pour le réutiliser.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉ / CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide - Selon EN 13727/EN 14561, conditions de propreté	5 min
Levuricide - Selon EN 13624/EN 14562, conditions de propreté	5 min
Mycobactéricide - Selon EN 14348/EN 14563, conditions de propreté	5 min
Fongicide - Selon EN 13624/EN 14562, conditons de propreté	5 min
Virucide - Selon EN 14476/EN 17111, conditions de propreté	5 min
Actif sur Adenovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté	5 min
Actif sur Norovirus - Selon EN 14476/EN 17111, conditons de propreté	5 min
Sporicide contre Clostridium difficile et Bacillus subtilis selon EN 17126, conditons de propreté	5 min

INFORMATIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
Anioxyde 1000 LD	4 bidons de 5 L + activateur intégré	282499HN
Anioxyde 1000 LD	Boîte de 50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans l'ANIOXYDE 1000 LD (1000 ppm)	100120

CE
0459

INDICATION

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : instrumentation médico-chirurgicale, matériel thermosensible et matériel d'endoscopie.

MODE D'EMPLOI

Solution à deux composants. Prête à l'emploi après activation.

Pour bidon de 5 L : Verser la totalité de l'activateur (flacon contenant 39,1ml) dans le générateur (bidon 5 L) puis verser la solution produite dans le bain de trempage.

Pour bidon de 1 L : Verser la totalité de l'activateur (flacon contenant 8,3ml) dans le générateur (flacon 1 L) puis verser la solution produite dans le bain de trempage.

Avant la 1ère utilisation, attendre au moins 30 minutes (temps nécessaire à l'activation du produit). Nettoyer et rincer soigneusement le dispositif médical avant le trempage dans ANIOXYDE 1000 LD (solution activée).

Contrôler le taux d'acide peracétique avec une bandelette de test ANIOXYDE 1000 LD en début de séance, à la reprise d'activité après interruption et toutes les 4 heures en cas d'activité consécutives.

Conservation maximale du bain de trempage : 14 jours sauf pour la France 7 jours maximum selon la réglementation française.

1. **Etape de pré-désinfection :** Nettoyer le dispositif médical avec un détergent ou un produit pré-désinfectant. Pour le matériel d'endoscopie : brosser les canaux.
2. **Etape de désinfection :** Verser la solution activée (voir la procédure d'activation sur l'étiquette/le protocole). Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Respecter le temps de contact minimum. Pour le matériel d'endoscopie : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux. N'ajouter aucun produit dans ANIOXYDE 1000 LD.
3. Rincer abondamment à l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie : rincer les parties internes et externes du dispositif médical.
4. Sécher avec un champ à usage unique. Garder le dispositif médical le plus aseptiquement possible pour le réutiliser.

COMPOSITION

Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA), ANIOXYDE 1000 LD générateur contient 3% de peroxyde d'hydrogène et des agents stabilisants.

CONDITIONS DE STOCKAGE


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOXYDE 1000 LD est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

BANDELETTES ANIOXYDE 1000 LD

INDICATIONS

50 bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000 LD.

MODE D'EMPLOI

- Tremper la bandelette pendant une seconde, la sortir en la secouant pour éliminer l'excès de liquide
- Lecture après 10 secondes
  Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle : CONFORME
  Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur : NON CONFORME
- Ne jamais interpréter un résultat obtenu plus de 15 secondes après trempage
- Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au mode d'emploi de l'étiquette de l'ANIOXYDE 1000 LD

CONDITIONS DE STOCKAGE

Refermer le tube après prélèvement d'une bandelette. Conserver à l'abri de l'humidité. Respecter la date limite d'utilisation reprise sur l'étiquette. Se conserve 90 jours après ouverture. Stocker entre +5°C et +25°C.


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eliminer le produit et son récipient en prenant toutes les précautions d'usage. Usage réservé aux professionnels.


CE


LECTURE APRÈS 10 SECONDES :

Conforme
Noir uniforme sur toute la plage réactionnelle



Non conforme
Coloration non uniforme, présence de points blanc, évanescence rapide de la couleur

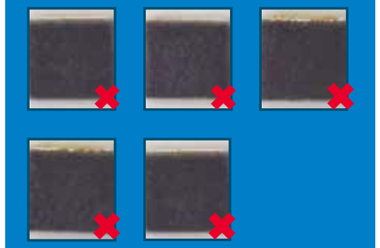



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

www.ecolab.com

© 2026 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-A.OXY1000LD-5039-3-NLFR-0226 2824DEA1

10048